
Guia do Paciente – Bomba de Infusão de Quimioterapia SMARTeZ®

Diagrama do Produto

1. Porta de preenchimento
2. Capa externa macia
3. Membrana elastomérica multicamada transparente
4. Pinça ON / OFF (aberta / fechada)
5. Equipo de administração em PVC sem DEHP
6. Filtro eliminador de ar e partículas
7. Restritor de fluxo
8. Conector do paciente
9. Tampa da extremidade do paciente
10. Tampa estéril colorida da porta de preenchimento
11. Rótulo – Volume de preenchimento e duração da infusão
12. Rótulo – Vazão (fluxo)

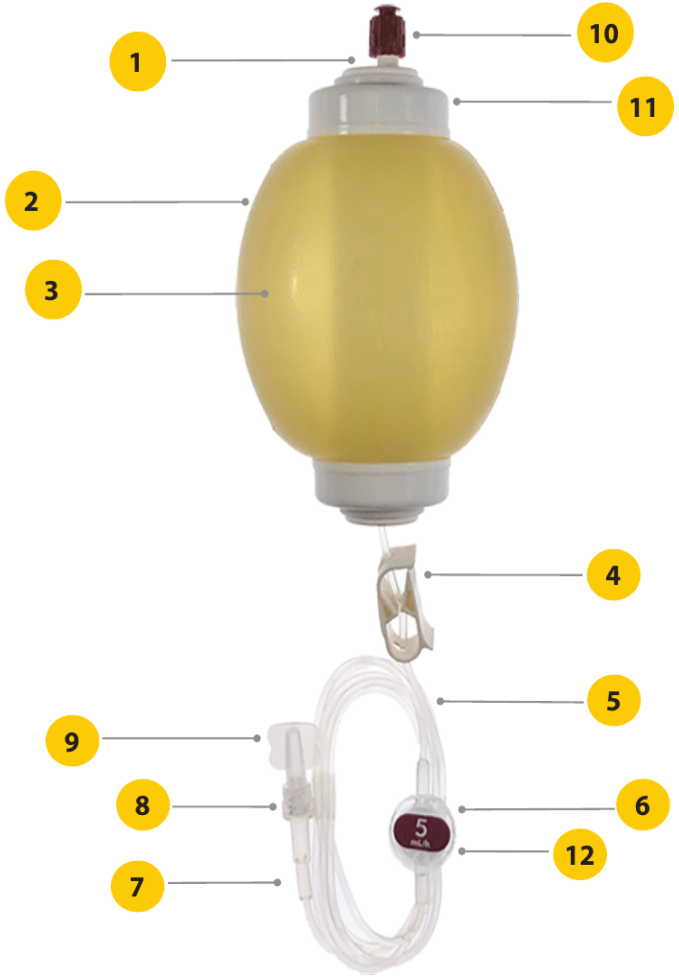

O Que Esperar

A bomba SMARTeZ® administra o medicamento por meio de uma bola em forma de balão e de um restritor de fluxo no equipo. Uma bomba preenchida com o medicamento será conectada ao seu acesso e a pinça ON/OFF será aberta. A bomba deve permanecer conectada, com a pinça na posição ON/ABERTA, durante todo o tempo de infusão. Converse com seu farmacêutico ou médico sobre o tempo de infusão previsto.

NÃO DESCONECTE ANTES DE DECORRIDO O TEMPO PRESCRITO
A bomba pode parecer vazia mesmo com medicamento restante.
Espere pouca mudança na aparência da bomba durante os últimos 25% da infusão.

Imagem da bomba **CHEIA**



O interior da bomba estará cheio de medicamento, redondo e firme. A capa externa ficará lisa e esticada.

Imagem da bomba **DURANTE** a infusão



Durante a infusão, o balão interno diminui de tamanho e a capa externa começa a formar rugas.

Imagem da bomba **VAZIA**



No fim da infusão, o balão interno se torna um cilindro alto e a capa externa colapsa.

Precauções

1. Não mergulhe a bomba na água.
2. Proteja o filtro para que não molhe.
3. Certifique-se de que o equipo está sem dobras e de que a pinça está na posição ON/ABERTA durante todo o tempo de infusão. Se notar dobras no equipo, role-o entre os dedos para desfazê-las.
4. Não deixe álcool ou detergentes entrarem em contato com o filtro, pois podem causar vazamento.
5. Não durma sobre a bomba.
6. Não aperte nem brinque com a bomba cheia, e tome cuidado ao usá-la em pacientes imobilizados.
7. O trecho do equipo entre o filtro e o conector do paciente deve ficar sob a roupa e em contato com o corpo.
8. Evite períodos prolongados de calor ou frio extremos.
9. Antes de iniciar a infusão, deixe a bomba atingir a temperatura ambiente (~23 °C ± 2 °C).

Tempos estimados abaixo:

Volume nominal de preenchimento	Temperatura de refrigeração	Tempo estimado para atingir a temperatura ambiente
50 ml – 100 ml	+2 a +8 °C	6 horas após a retirada da refrigeração
50 ml – 100 ml	-18 °C	12 horas após a retirada da refrigeração
Acima de 100 ml	+2 a +8 °C	12 horas após a retirada da refrigeração
Acima de 100 ml	-18 °C	18 horas após a retirada da refrigeração

10. Consulte seu farmacêutico, enfermeiro ou médico sobre a duração prevista da infusão.

Tradução para português (Brasil) do guia original da EPIC em inglês. Em caso de dúvida, prevalece o documento original.